



III — оба контакта размыкающие,


Левый указатель (min) синий, правый (max) — красный.

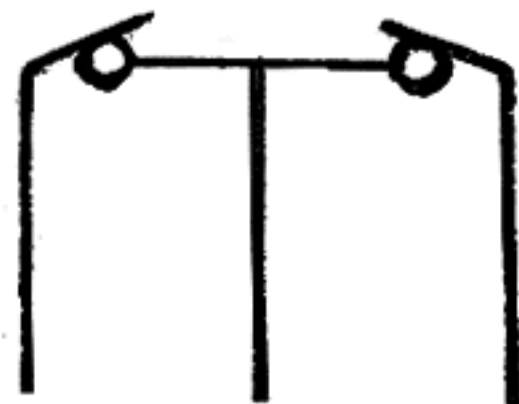


IV — оба контакта замыкающие.  
Левый указатель (min) красный, правый (max) — синий.

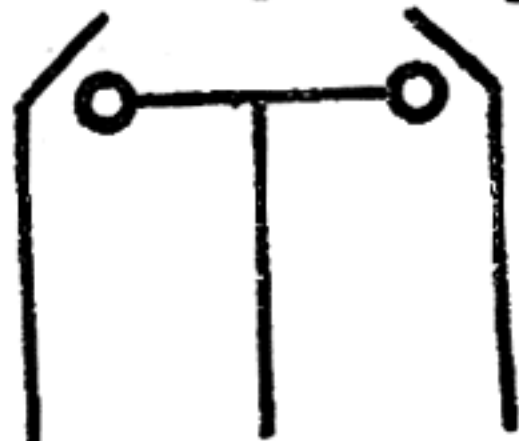

V — один контакт размыкающий (min), другой замыкающий (max)  
Оба указателя синие.

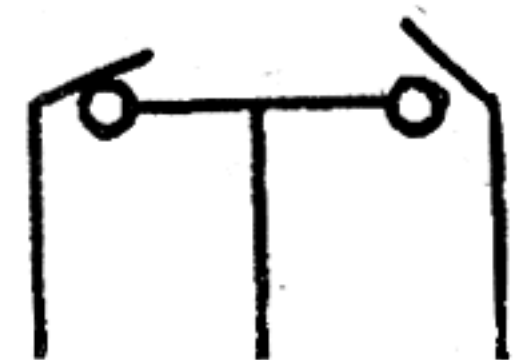

VI — один контакт замыкающий (min), другой размыкающий (max).  
Оба указателя красные.

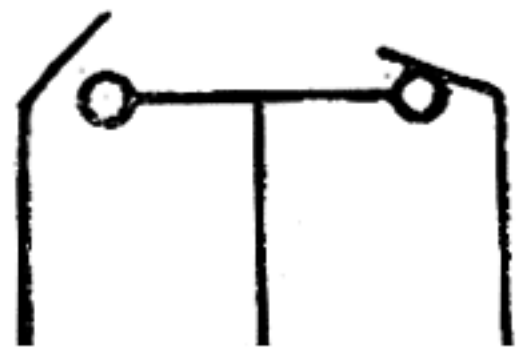

**Примечание.** В момент достижения стрелкой давления установки левого или правого указателя контакт размыкается (замыкается).

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ME65.B01374

Срок действия с 25.04.2008

по 25.04.2011

7932601

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** РОСС. RU. 0001. 11ME65  
Орган по сертификации средств измерений "Сомет" АНО "Поток-Тест"  
(ОС "Сомет")  
119361, Москва, ул. Озерная, 46 тел.: (495) 437-29-22

**ПРОДУКЦИЯ**

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие  
сигнализирующие ДМ 2005Сг, ДВ 2005Сг, ДА 2005Сг, ДМ 2005Сг1Ех,  
ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех, ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг  
ТУ 4212-040-00225590-2001

серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 12997-84 Пп. 2.16, 2.25, 2.27, 2.28, разд. 3;  
ГОСТ 2405-88 Пп. 2.1.7.4.1, 2.1.7.4.2, 2.1.8, 2.4.1-2.4.3, 6.2, 6.3

код ОК 005 (ОКП):

**4 2 1 2 1 4**

код ТН ВЭД России:

**9 0 2 6 2 0 4 0 0 0**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОАО "Манотомь", ИНН: 7021000501  
634061, Россия, г.Томск, пр. Комсомольский, 62

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ОАО "Манотомь"  
634061, Россия, г.Томск, пр. Комсомольский, 62  
тел: (3822) 442-628, факс: (3822) 442-906

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол  
№ 700 от 16.04.2008

ИЛСИ ФГУП "ВНИИМС" Россия 119361 Москва  
Озерная, 46

РОСС RU.0001.21ME98


**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Маркирование продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92



Руководитель органа

Эксперт

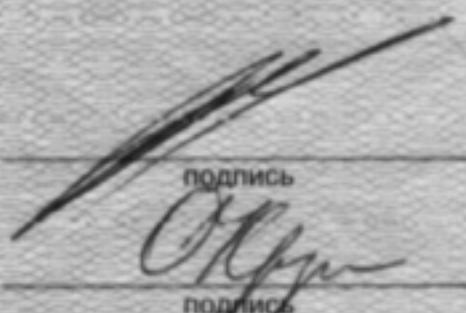подпись  
  
подпись

**В.Н.Яншин**

инициалы, фамилия

**О.В.Круг**

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.30.004.A № 14894

Действителен до  
" 01 " июля 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип **манометров, вакуумметров и мановакуумметров** **показывающих сигнализирующих ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг**,  
наименование средства измерений  
**ОАО "Манотомь", г.Томск**,  
наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **13535-93** и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель  
Руководителя



**В.Н.Крутиков**

02 " 02 " 2008 г.

Продлен до

"....." ..... г.

Заместитель  
Руководителя

"....." ..... 200 г.