

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.АЯ22.В18268

Срок действия с 01.10.2008

по 30.09.2011

8073279

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ22  
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА"  
302004, г.Орел, ул.Ливенская, д.15, тел. 73-40-13, факс 73-52-58

ПРОДУКЦИЯ преобразователи давления КРТ 5: КРТ5-1, КРТ5-2,  
КРТ5-3, КРТ5-4, КРТ5-11, КРТ5-22, КРТ5-33, КРТ5-44  
ТУ 4212-174-00227459-99  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
42 1281

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 12997-84 пп. 2.16, 2.25, Разд. 3., ГОСТ 22520-85 п.п. 1.3, 2.14.,  
2.20, 7.1, Разд. 3.; ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97)


КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ОРЛЭКС". ИНН:5753004282  
г. Орел, ул. Ломоносова, 6

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество "ОРЛЭКС". Код-ОКПО:00227459.  
ИНН:5753004282  
г. Орел, ул. Ломоносова, 6, тел. 41-44-81

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №14 от 29.09.2008г. ИЦ датчиков-реле давления,  
температуры, преобразователей, электробытовых приборов и игрушек ЗАО "ОРЛЭКС",  
рег. № РОСС RU.0001.22АЯ41,  
протокола испытаний №МА08МИ63ОЦ от 22.05.2008г. ИЛ изделий - источников радиопомех  
по параметрам ЭМС ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа",  
рег. № РОСС RU.0001.21МЭ11,  
акта о результатах анализа состояния производства № 310 от 01.10.2008


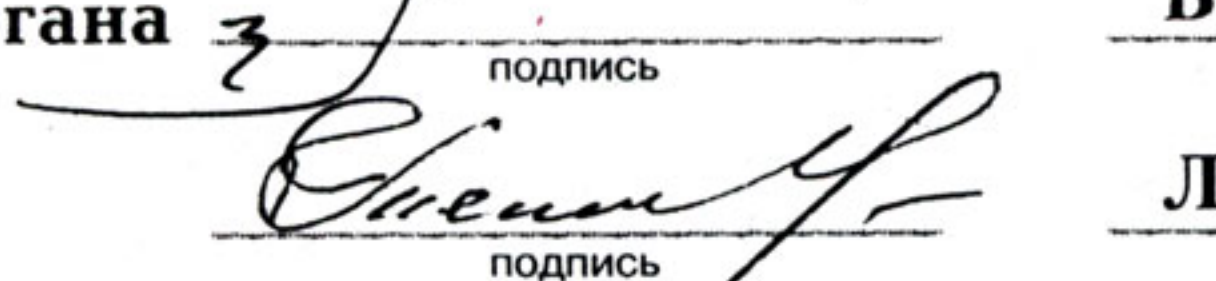
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на руководстве  
по эксплуатации и этикетке тары  
Схема сертификации за.

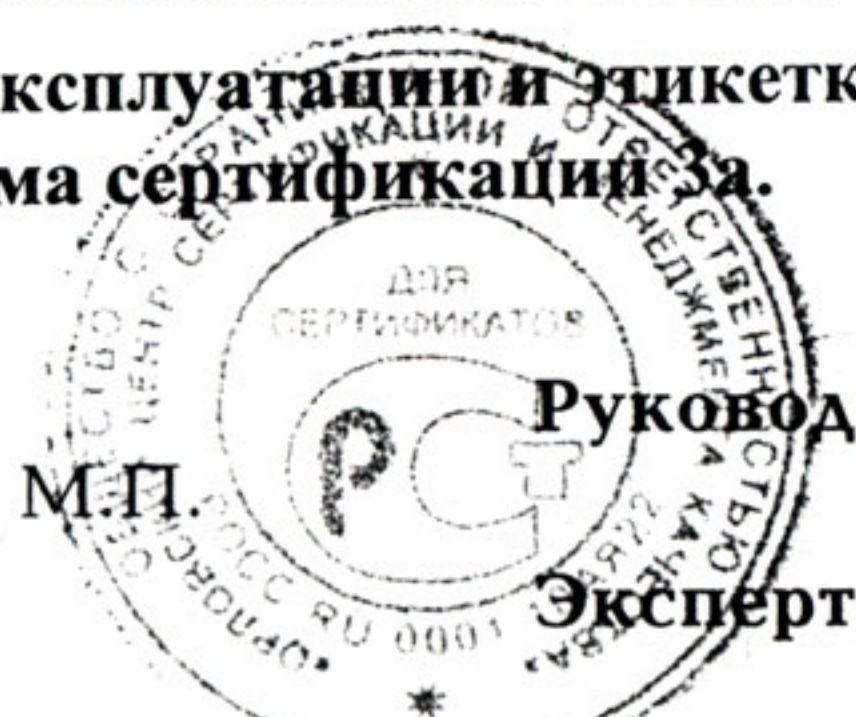

Руководитель органа

М.П.

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

В.П.Гашенко

инициалы, фамилия

Л.И.Тенетилова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

## PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.30.000.A № 8919

Действителен до  
" 01 " декабря 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип преобразователей давления КРТ 5

наименование средства измерений

ЗАО "Орлэкс", г.Орел

наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **20409-00** и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель  
Руководителя



**В.Н.Крутиков**

" 04 " 12 2005 г.

Продлен до

" ..... " ..... Г.

Заместитель  
Руководителя

" ..... " ..... 200 г.